

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número: 011562

Página 1 de 5

LABORATORIO:

Laboratory

DEPARTAMENTO DE METROLOGIA

INSTRUMENTO:

Instrument

MANOMETRO

FABRICANTE:

Manufacturer

BOURDON HAENNI

MODELO:

Model

ANALOGICO

NUMERO DE SERIE:

Serial Number

PMC 4849

UBICACIÓN

Location

LABORATORIO DE METROLOGÍA

RANGO DE MEDICION:

Measurement Range

0 - 15 inH2O

RESOLUCIÓN:

Resolution

0.125

SOLICITANTE:

Customer

LIDER DE METROLOGÍA

DIRECCIÓN:

Address

CALLE 39 D N° 28-52 EMPORIO

FECHA DE RECEPCIÓN:

Date of Reception

2023-03-23

FECHA DE CALIBRACIÓN:

Date of Calibration

2023-03-23

NUMERO DE PAGINAS INCLUYENDO ANEXOS:

Number of Pages and Document Attached

5

Calibrado Por:

Calibrate by:

Aprobado Por:

Checked by:

YEISON QUINCHUCUA

Técnico en Metrología

Ing. Fabian Contreras

Jefe Laboratorio de Metrología

Fecha De Emision null

Este reporte expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite. Los resultados contenidos en el presente Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

This report expresses faithfully the result of measurements. It may not be reproduced in whole or in part except when obtained prior written permission of the issuing laboratory. The results contained in this report refer to the time and conditions under which measurements were made. The laboratory that issues not responsible for damages that may result from improper use of calibrated instruments. The user is responsible for the recalibration of instruments at appropriate intervals.

1. No de Informe 11562

Internal Code

2. Trazabilidad de la Medición

Traceability

Los patrones utilizados en la calibración de este instrumento están trazados a los patrones nacionales, los cuales tienen trazabilidad a patrones internacionales reconocidos.

Descripción (Description)	MANOMETRO DIGITAL(SN 218161B0035)
Tipo (Type)	PRESION
Fabricante (Manufacturer)	ADDITEL
Serie	218161B0035
Rango de Medición	0 - 830 inH2O
Resolución	0.01 inH2O
Certificado de Calibración	CMK-PRES-220526

3. Metodo de Calibración.

Calibration Method

Los lineamientos generales de calibración que se describen a continuación, se apoyan en las normas OIML R101, OIML R109 El manometro referido fue comparado con MANOMETRO DIGITAL, las lecturas del calibrando se efectuaron en ascenso y descenso; en el intermedio de las series el manometro se mantuvo durante veinte minutos en carga maxima.

4. Incertidumbre Estimada de la Medición.

Measurement uncertainty

La incertidumbre de medición (U), reportada en la tabla de resultados, es la incertidumbre estandar combinada, multiplicada por un factor de cobertura $k = 2$, con lo cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

5. Condiciones Ambientales

Enviromental Conditions


Temperatura Ambiente	20.9 °C
Room Temperature	
Humedad Relativa	59.2 HR
Relative Humidity	
Presión Atmosferica	1013.0 hpa
Atmospheric Pressure	

6. Resultados de la Calibración

De Llegada (AS FOUND)

Indicación Patrón	Indicación Instrumento Ascenso	Indicación Instrumento Descenso	Error Max. Relativo A La Escala	Maxima de Presión
0.0	0.0	null	0,0000%	0,500
1.5	1.0	null	-3,3333%	
3.0	2.5	null	-3,3333%	
4.5	4.5	null	0,0000%	
6.0	5.875	null	-0,8333%	
9.0	null	9.25	1,6667%	
10.5	null	10.725	1,5000%	
12.0	null	12.375	2,5000%	
13.5	null	14.0	3,3333%	
15.0	null	14.875	-0,8333%	
7.5	7.25	7.75	1,6667%	U
0.0	null	0.0	0,0000%	0,470
1.5	null	1.375	-0,8333%	
3.0	null	2.875	-0,8333%	
4.5	null	4.375	-0,8333%	
6.0	null	5.875	-0,8333%	
9.0	9.0	null	0,0000%	


DIAGRAMA DE CALIBRACION

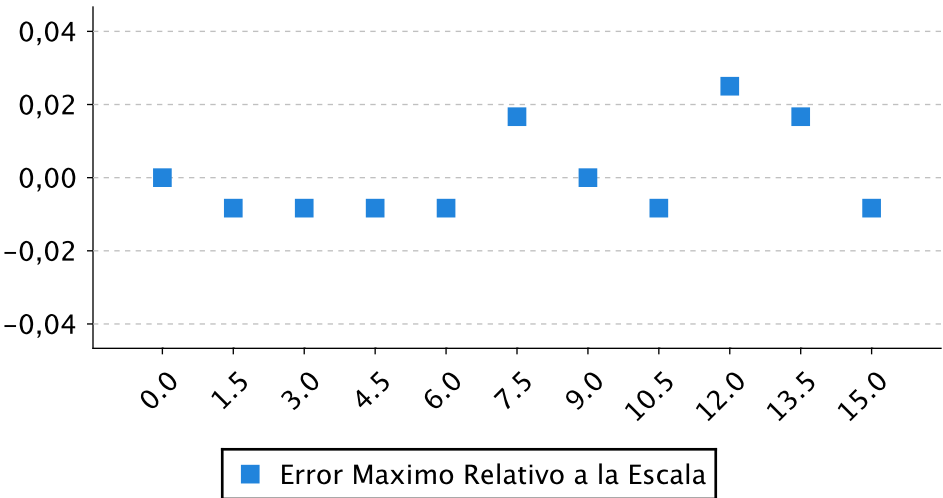

Max Error (%)=	3,333	%	±3,135
Max Error (inH2O)=	0,500	inH2O	±0,470

De Llegada (AS FOUND)

Indicación Patrón	Indicación Instrumento Ascenso	Indicación Instrumento Descenso	Error Max. Relativo A La Escala	Maxima de Presión
10.5	10.375	null	-0,8333%	
12.0	12.375	null	2,5000%	
13.5	13.75	null	1,6667%	
15.0	14.875	null	-0,8333%	

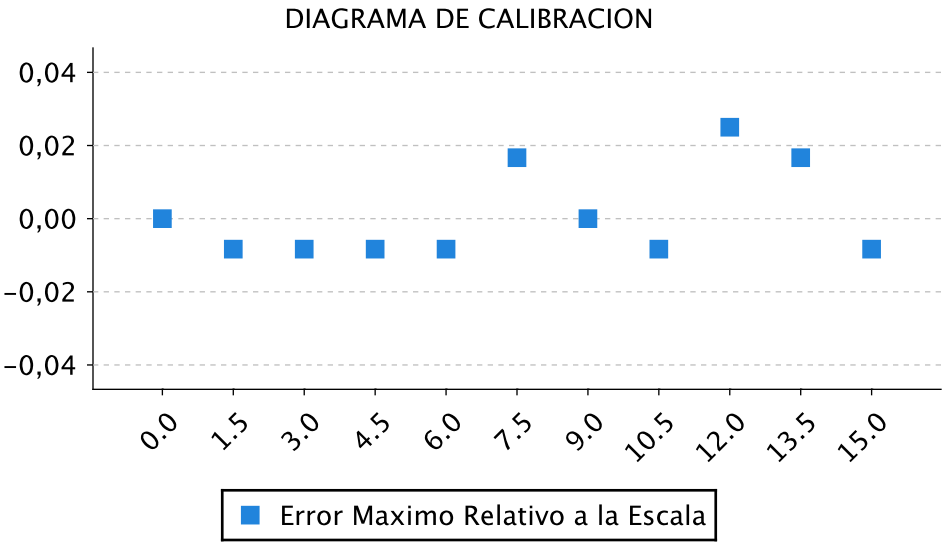

Max Error (%)=	3,333	%	±3,135
Max Error (inH2O)=	0,500	inH2O	±0,470

7. Observaciones

Remarks

* Con el certificado de calibración se entrega una estampilla del Departamento de Metrología de Llanogas SA ESP, que contiene fecha y número del certificado de calibración, la cual va adherida al equipo.

* La máxima diferencia en porcentaje, respecto a la full escala es de: 3,33%.

* El porcentaje de error así obtenido, es permitido en manómetros que corresponden a la clase de exactitud 4,00

* Se ajusta aguja de manómetro.