

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número: 002114

Página 1 de 9

LABORATORIO:

Laboratory

DEPARTAMENTO DE METROLOGIA

INSTRUMENTO:

Instrument

ELECTROCORRECTOR DE FLUJO \EAGLE RESEARCH

FABRICANTE:

Manufacturer

MODELO SERIE E

MODELO:

Model

NUMERO DE SERIE:

Serial Number

1314

UBICACIÓN

Location

LABORATORIO DE METROLOGIA

RANGO DE MEDICION:

Measurement Range

0 - 300 PSI, 0 - 5000 PSI, -31 - 71 °C

RESOLUCIÓN:

Resolution

0.01

SOLICITANTE:

Customer

LIDER DE METROLOGIA

DIRECCIÓN:

Address

FECHA DE RECEPCIÓN:

Date of Reception

2020-01-22

FECHA DE CALIBRACIÓN:

Date of Calibration

2020-01-22

NUMERO DE PAGINAS INCLUYENDO ANEXOS:

Number of Pages and Document Attached

9

Calibrado Por:

Calibrate by:

Aprobado Por:

Checked by:

ANDRES MEJIA
Técnico en Metrología

Ing. Fabian Contreras
Jefe Laboratorio de Metrología

Fecha De Emision null

Este reporte expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite. Los resultados contenidos en el presente Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

This report expresses faithfully the result of measurements. It may not be reproduced in whole or in part except when obtained prior written permission of the issuing laboratory. The results contained in this report refer to the time and conditions under which measurements were made. The laboratory that issues not responsible for damages that may result from improper use of calibrated instruments. The user is responsible for the recalibration of instruments at appropriate intervals.

1. No de Informe 2114

Internal Code

2. Trazabilidad de la Medición

Traceability

Los patrones utilizados en la calibración de este instrumento están trazados a los patrones nacionales, los cuales tienen trazabilidad a patrones internacionales reconocidos.

Descripción (Description)	MANOMETRO DIGITAL(SN 21816220002)	MANOMETRO DIGITAL(SN 367975)	TRANSMISORES DE TEMPERATURA(SN A82080)
Tipo (Type)	PRESION	PRESION	TEMPERATURA
Fabricante (Manufacturer)	ADDITEL	CRYSTAL	9142
Serie	21816220002	367975	A82080
Rango de Medición	0 - 5000 PSI	0 - 300 PSI	-25 - 150 °C
Resolución	0.1 PSI	0.01 PSI	0.01 °C
Certificado de Calibración	CERT-19-EMP-801-3393	CERT-19-EMP-1152-3393	CMK-TEMPA-19015

3. Metodo de Calibración.

Calibration Method

3.1 Sistema de Medición de presión asociado al corrector de Flujo

La calibracion fue hecha mediante comparacion directa con un patrón trazable nacional e internacionalmente, cumpliendo con los requisitos metrologicos minimos establecidos.
Las lecturas del calibrando se efectuaron tomando cinco (5) puntos de la escala del instrumento.
Para transmitir presión se hace uso de una bomba neumatica.

3.2 Sistema de Medición de Temperatura asociado al corrector de Flujo

La calibracion fue hecha mediante comparación directa con patrón trazable nacional e internacionalmente, bloque seco termico FLUKE 9142. Con PT-100 de precisión ± 0.02 °C. Se efectuan 3 mediciones en la totalidad del rango del instrumento, durante un periodo de estabilización con 3 lecturas en cada punto.

4. Incertidumbre Estimada de la Medición.

Measurement uncertainty

La incertidumbre de medición (U), reportada en la tabla de resultados, es la incertidumbre estandar combinada, multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con lo cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente el 95%; en los sitemas de medición de presión y temperaturaasociados al corrector de flujo.

5. Condiciones Ambientales


Enviromental Conditions

Temperatura Ambiente	21.9 °C
Room Temperature	
Humedad Relativa	66.1 HR
Relative Humidity	
Presión Atmosferica	954.0 hpa
Atmospheric Pressure	

6. Resultados de la Calibración

AS FOUND. Resultados sistema de medición de temperatura.

No Prueba	Indicación Instrumento	Indicación Patrón	Error Max.	Resultado
				Error
1,000	14,290	15,000	-0,710	-0,710
2,000	24,787	25,000	-0,213	U
3,000	34,807	35,000	-0,193	0,443

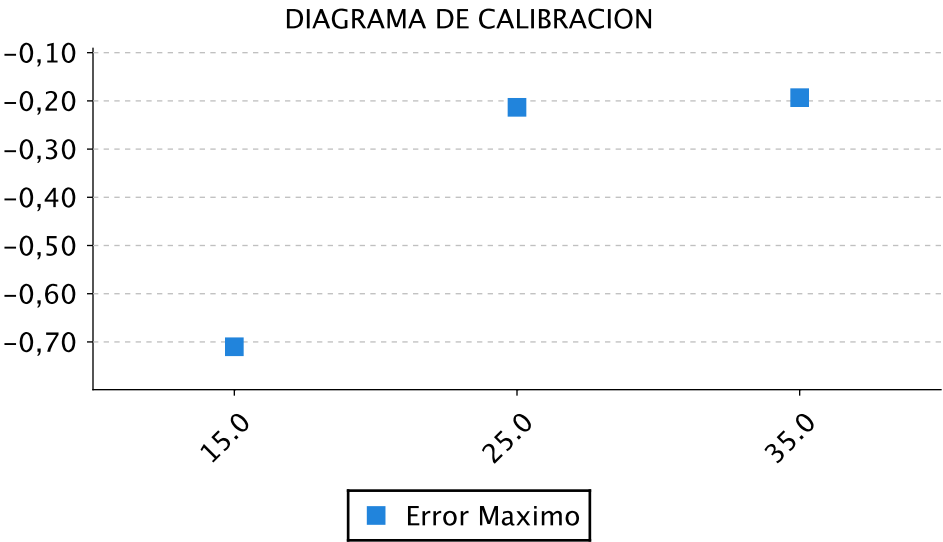


Max Error (%)=	-0,71 %	±0,443
----------------	---------	--------

AS FOUND. Resultados sistema de medicion de presión.

Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	0,270	0,270	0,090%	0,357
75,000	74,440	-0,560	-0,187%	
150,000	149,280	-0,720	-0,240%	U
225,000	224,130	-0,870	-0,290%	0,018
300,000	298,930	-1,070	-0,357%	

DIAGRAMA DE CALIBRACION

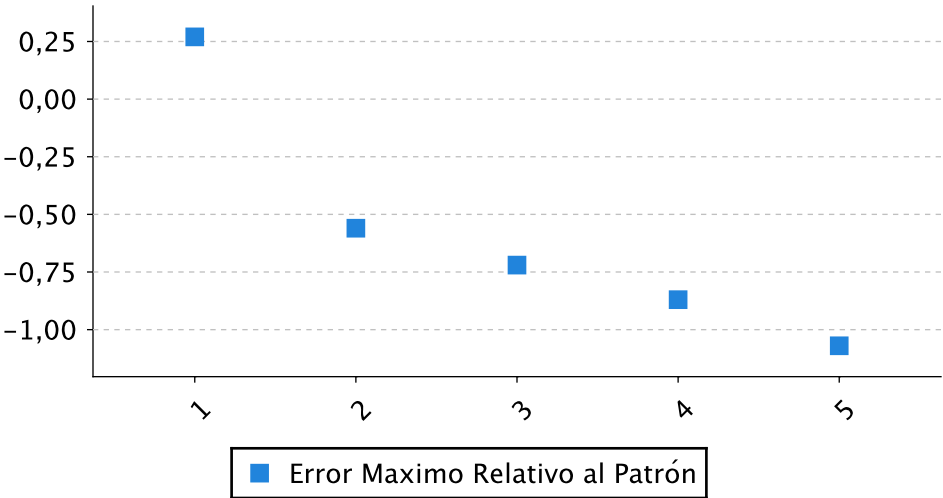


Max Error (%)=	0,357 %	±0,018
----------------	---------	--------

AS FOUND. Resultados sistema de medicion de presión.

Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	12,000	12,000	0,240%	0,558
1250,000	1240,190	-9,810	-0,196%	
2500,000	2484,700	-15,300	-0,306%	U
3750,000	3722,090	-27,910	-0,558%	0,003
5000,000	4984,800	-15,200	-0,304%	

DIAGRAMA DE CALIBRACION

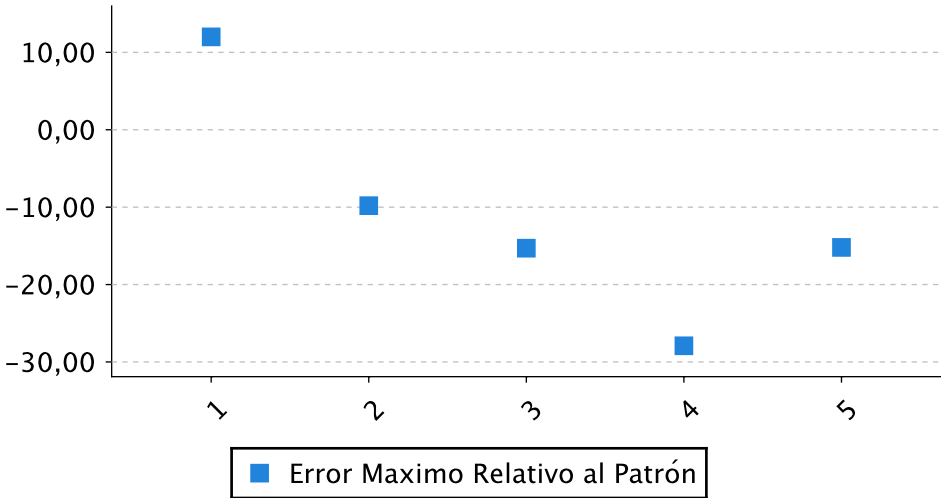


Max Error (%)=	0,558 %	±0,003
----------------	---------	--------

AS LEFT. Resultados sistema de medicion de temperatura.

No Prueba	Indicación Instrumento	Indicación Patrón	Error Max.	Resultado
				Error
1,000	15,037	15,000	0,037	0,037
2,000	25,037	25,000	0,037	U
3,000	35,013	35,000	0,013	0,406


DIAGRAMA DE CALIBRACION

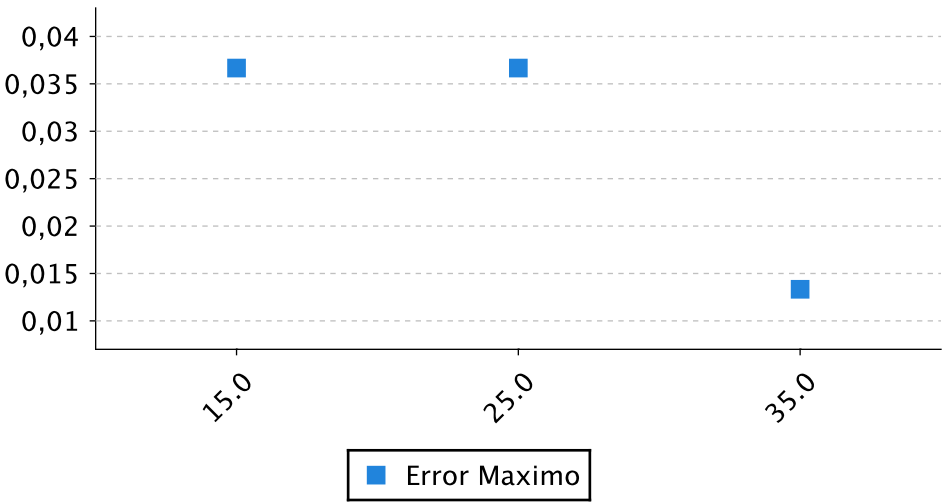

Max Error (%)=	0,037 %	±0,406
----------------	---------	--------

AS LEFT. Resultados sistema de medicion de presión.

Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	0,000	0,000	0,000%	0,060
75,000	74,950	-0,050	-0,017%	
150,000	150,020	0,020	0,007%	U
225,000	225,140	0,140	0,047%	0,018
300,000	300,180	0,180	0,060%	

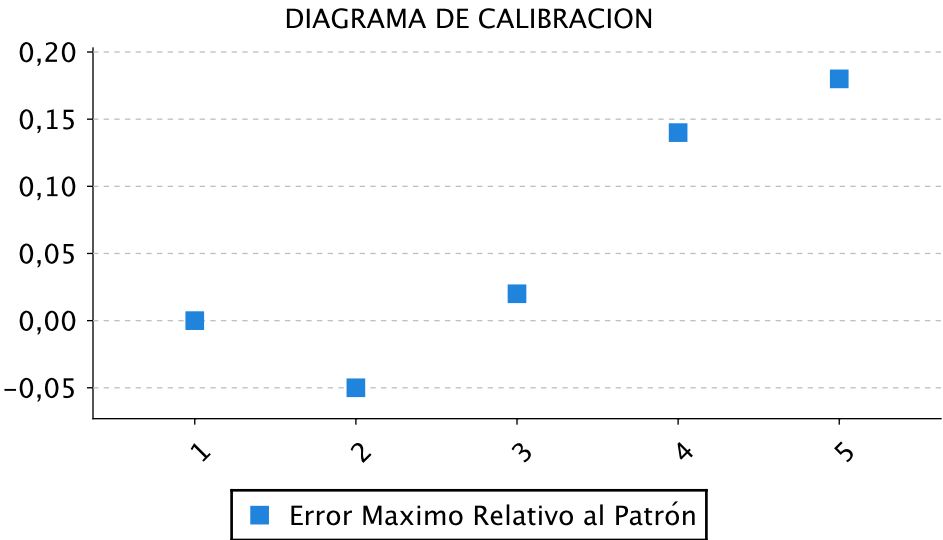


Max Error (%)=	0,060 %	±0,018
----------------	---------	--------

AS LEFT. Resultados sistema de medicion de presión.

Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	0,250	0,250	0,005%	0,078
1250,000	1253,900	3,900	0,078%	
2500,000	2502,580	2,580	0,052%	U
3750,000	3752,140	2,140	0,043%	0,003
5000,000	5000,630	0,630	0,013%	

DIAGRAMA DE CALIBRACION

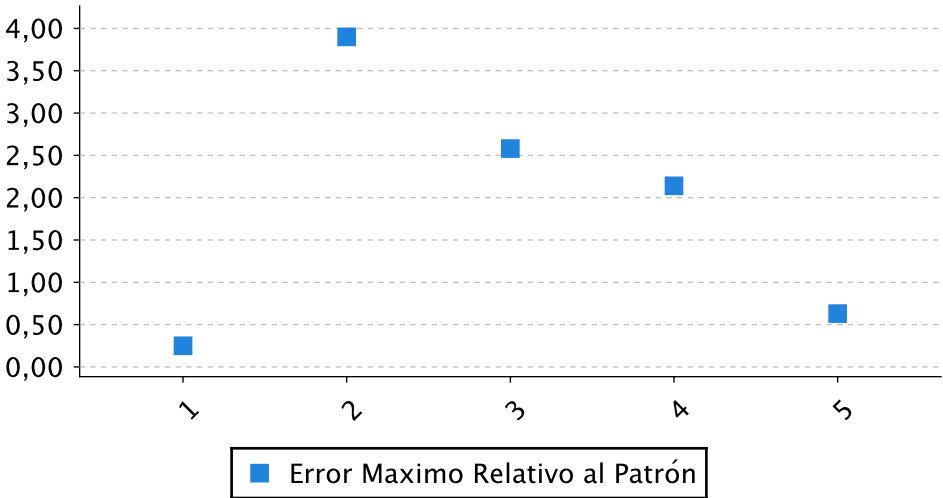

Max Error (%)=	0,078	%	±0,003
----------------	-------	---	--------

7. Observaciones

Remarks

- * *El sistema de presión de 0.0 a 300.0 PSI fue ajustado durante el proceso de calibración.*
- * *El sistema de temperatura fue ajustado durante el proceso de calibración.*
- * *El sistema de presión de 0.0 a 5000.0 PSI fue ajustado durante el proceso de calibración.*
- * *Se calibra sin novedades*