

## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número: 004772

Página 1 de 4

**LABORATORIO:** DEPARTAMENTO DE METROLOGIA  
*Laboratory*

**INSTRUMENTO:** VALVULA DE SEGURIDAD N°04  
*Instrument*

**FABRICANTE:** FARINOLA E HIJOS  
*Manufacturer*

**MODELO:** 603.5111  
*Model*

**NUMERO DE SERIE:** 4578-1-10/03  
*Serial Number*

**UBICACIÓN:** TERCERA ETAPA EC CAÑOS NEGROS  
*Location*

**RANGO DE MEDICION:** 0 - 275 Bar  
*Measurement Range*

**RESOLUCIÓN:** 0.01  
*Resolution*

**SOLICITANTE:** LIDER DE MANTENIMIENTO GNV  
*Customer*

**DIRECCIÓN:** VEREDA CAÑOS NEGROS  
*Address*

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 2023-05-18  
*Date of Reception*

**FECHA DE CALIBRACIÓN:** 2023-05-18  
*Date of Calibration*

**NUMERO DE PAGINAS INCLUYENDO ANEXOS:** 4  
*Number of Pages and Document Attached*

Calibrado Por:

*Calibrate by:*



DANIEL ANTONIO UNDA  
*Técnico en Metrología*

Aprobado Por:

*Checked by:*



Ing. Fabian Contreras  
*Jefe Laboratorio de Metrología*

Fecha De Emision 2023-05-25

Este reporte expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite. Los resultados contenidos en el presente Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

This report expresses faithfully the result of measurements. It may not be reproduced in whole or in part except when obtained prior written permission of the issuing laboratory. The results contained in this report refer to the time and conditions under which measurements were made. The laboratory that issues not responsible for damages that may result from improper use of calibrated instruments. The user is responsible for the recalibration of instruments at appropriate intervals.

**1. No de Informe 4772***Internal Code***2. Trazabilidad de la Medición***Traceability*

Los patrones utilizados en la calibración de este instrumento están trazados a los patrones nacionales, los cuales tienen trazabilidad a patrones internacionales reconocidos.

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Descripción (Description)</b>  | <b>MANOMETRO DIGITAL(SN 211H16640014)</b> |
| <b>Tipo (Type)</b>                | PRESION                                   |
| <b>Fabricante (Manufacturer)</b>  | ADDITEL DIGITAL                           |
| <b>Serie</b>                      | 211H16640014                              |
| <b>Rango de Medición</b>          | 0 - 703 Bar                               |
| <b>Resolución</b>                 | 0.01 Bar                                  |
| <b>Certificado de Calibración</b> | CLP-81122                                 |

**3. Metodo de Calibración.***Calibration Method*

Los lineamientos generales de calibración que se describen a continuación, se apoyan en las normas OIML R101, OIML R109. El valvula de seguridad referido fue comparado con MANOMETRO DIGITAL, las lecturas del calibrando se efectuaron en ascenso y descenso; en el intermedio de las series el valvula de seguridad se mantuvo durante veinte minutos en carga maxima.

**4. Incertidumbre Estimada de la Medición.***Measurement uncertainty*

La incertidumbre de medición (U), reportada en la tabla de resultados, es la incertidumbre estandar combinada, multiplicada por un factor de cobertura  $k = 2$ , con lo cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.


**5. Condiciones Ambientales***Environmental Conditions*

|  |           |
|--|-----------|
| Temperatura Ambiente<br><i>Room Temperature</i>    | 28.6 °C   |
| Humedad Relativa<br><i>Relative Humidity</i>       | 75.6 HR   |
| Presión Atmosferica<br><i>Atmospheric Pressure</i> | 900.0 hpa |

6. Resultados de la Calibración

| No. Prueba              | Presión Disparo | Presión Recuperación | U Disparo | U Recuperación |
|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------|----------------|
| 1                       | 276,41          | 260,63               | 1,172     | 0,798          |
| 2                       | 277,08          | 261,39               |           |                |
| 3                       | 277,46          | 260,88               |           |                |
| <b>Promedio</b>         | 276,98          | 260,97               |           |                |
| <b>Error Max.</b>       | 2,46            |                      |           |                |
| <b>SETTING AS FOUND</b> |                 | <b>277.56 Bar</b>    |           |                |

DIAGRAMA DE CALIBRACION

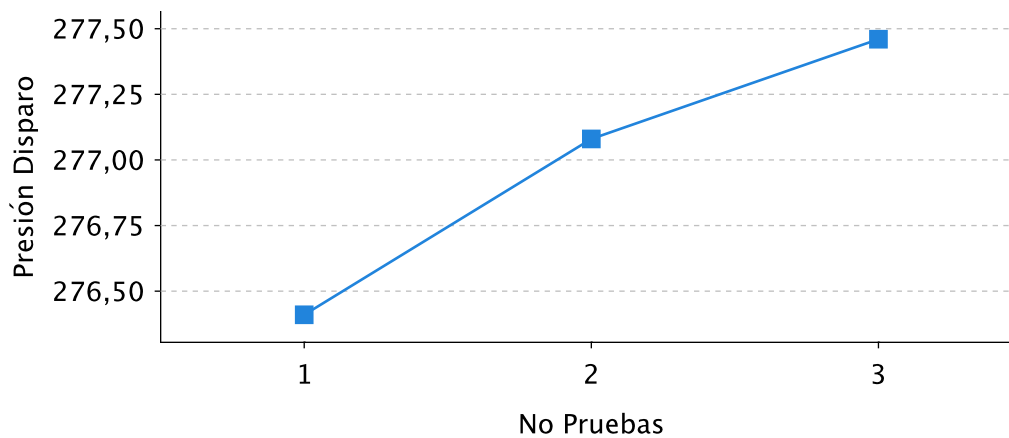

■ Presión Disparo

|                                  |                    |                |
|----------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>Presión de Disparo =</b>      | <b>276,983 Bar</b> | <b>±1,172</b>  |
|                                  | <b>0,721%</b>      | <b>±0,423%</b> |
| <b>Presión de Recuperación =</b> | <b>260,967 Bar</b> | <b>±0,798</b>  |
|                                  | <b>-0,162%</b>     | <b>±0,306%</b> |

## 7. Observaciones

*Remarks*

\* *precinto 12650*

FIN DE DOCUMENTO.