

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número: 011762

Página 1 de 5

LABORATORIO:	DEPARTAMENTO DE METROLOGIA
Laboratory	
INSTRUMENTO:	MANOMETRO
Instrument	
FABRICANTE:	NUOVA FIMA
Manufacturer	
MODELO:	ANALOGICO
Model	
NUMERO DE SERIE:	20180014
Serial Number	
UBICACIÓN	PRIMERA ETAPA EDS EL YOPO
Location	
RANGO DE MEDICION:	0 - 100 Bar
Measurement Range	
RESOLUCIÓN:	2
Resolution	
SOLICITANTE:	LIDER DE MANTENIMIENTO GNV
Customer	
DIRECCIÓN:	CALLE 30 N° 13 - 47 VILLA ROCIO - YOPAL
Address	
FECHA DE RECEPCIÓN:	2023-07-25
Date of Reception	
FECHA DE CALIBRACIÓN:	2023-07-25
Date of Calibration	
NUMERO DE PAGINAS INCLUYENDO ANEXOS:	5
Number of Pages and Document Attached	
Calibrado Por:	Aprobado Por:
Calibrate by:	Checked by:

DANIEL ANTONIO UNDA
Técnico en Metrología

Ing. Fabian Contreras
Jefe Laboratorio de Metrología

Fecha De Emision 2023-07-31

Este reporte expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite. Los resultados contenidos en el presente Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

This report expresses faithfully the result of measurements. It may not be reproduced in whole or in part except when obtained prior written permission of the issuing laboratory. The results contained in this report refer to the time and conditions under which measurements were made. The laboratory that issues not responsible for damages that may result from improper use of calibrated instruments. The user is responsible for the recalibration of instruments at appropriate intervals.

1. No de Informe 11762

Internal Code

2. Trazabilidad de la Medición

Traceability

Los patrones utilizados en la calibración de este instrumento están trazados a los patrones nacionales, los cuales tienen trazabilidad a patrones internacionales reconocidos.

Descripción (Description)	MANOMETRO DIGITAL(SN 211H16640014)
Tipo (Type)	PRESION
Fabricante (Manufacturer)	ADDITEL DIGITAL
Serie	211H16640014
Rango de Medición	0 - 703 Bar
Resolución	0.01 Bar
Certificado de Calibración	CLP-81122

3. Metodo de Calibración.

Calibration Method

Los lineamientos generales de calibración que se describen a continuación, se apoyan en las normas OIML R101, OIML R109 El manometro referido fue comparado con MANOMETRO DIGITAL, las lecturas del calibrando se efectuaron en ascenso y descenso; en el intermedio de las series el manometro se mantuvo durante veinte minutos en carga maxima.

4. Incertidumbre Estimada de la Medición.

Measurement uncertainty

La incertidumbre de medición (U), reportada en la tabla de resultados, es la incertidumbre estandar combinada, multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con lo cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

5. Condiciones Ambientales

Enviromental Conditions


Temperatura Ambiente	28.5 °C
Room Temperature	
Humedad Relativa	75.2 HR
Relative Humidity	
Presión Atmosferica	900.0 hpa
Atmospheric Pressure	

6. Resultados de la Calibración

De Llegada (AS FOUND)

Indicación Patrón	Indicación Instrumento Ascenso	Indicación Instrumento Descenso	Error Max. Relativo A La Escala	Maxima de Presión
0.0	0.0	0.0	0,0000%	9,800
10.0	6.5	6.9	-3,5000%	
20.0	15.9	17.5	-4,1000%	
30.0	27.8	28.5	-2,2000%	
40.0	45.9	49.8	9,8000%	
50.0	57.8	58.3	8,3000%	U
60.0	64.2	68.5	8,5000%	0,949
70.0	73.5	76.5	6,5000%	
80.0	89.1	89.4	9,4000%	
90.0	96.5	97.4	7,4000%	
100.0	104.2	105.4	5,4000%	


DIAGRAMA DE CALIBRACION

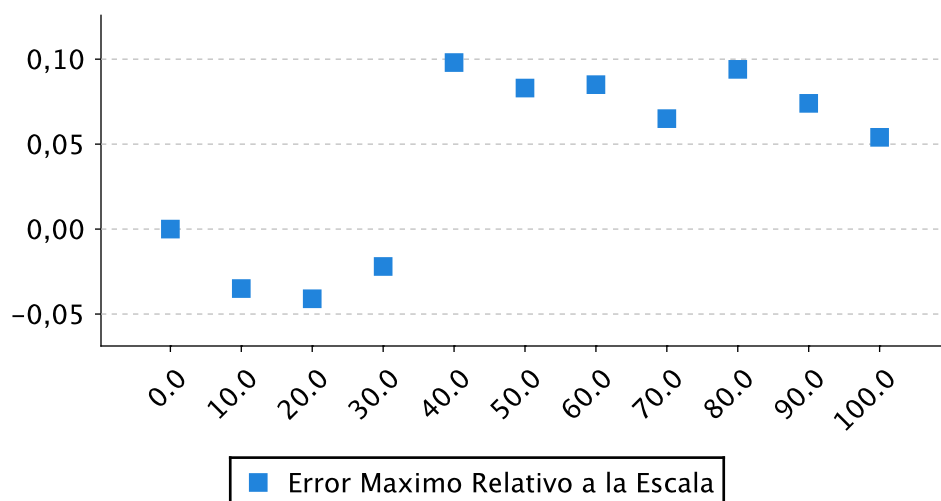

Max Error (%)=	9,8 %	±0,949
Max Error (Bar)=	9,800 Bar	±0,949

Calibración Después Del Ajuste (AS LEFT)

Indicación Patrón	Indicación Instrumento Ascenso	Indicación Instrumento Descenso	Error Max. Relativo A La Escala	Maxima de Presión
0.0	0.0	0.0	0,0000%	0,000
0.0	0.0	0.0	0,0000%	
0.0	0.0	0.0	0,0000%	
0.0	0.0	0.0	0,0000%	
0.0	0.0	0.0	0,0000%	
0.0	0.0	0.0	0,0000%	U
0.0	0.0	0.0	0,0000%	0,125
0.0	0.0	0.0	0,0000%	
0.0	0.0	0.0	0,0000%	
0.0	0.0	0.0	0,0000%	
0.0	0.0	0.0	0,0000%	

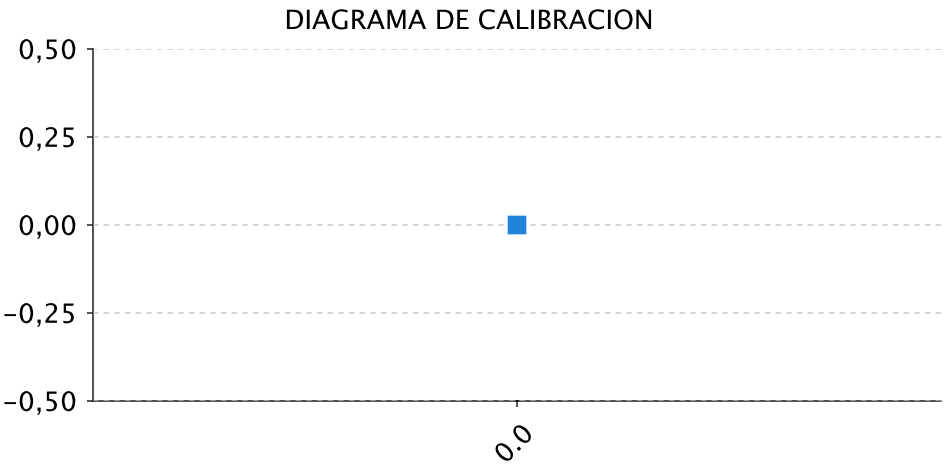

■ Error Maximo Relativo a la Escala

Max Error (%)=	0	%	±0,125
Max Error (Bar)=	0,000	Bar	±0,125

7. Observaciones

Remarks

* Con el certificado de calibración se entrega una estampilla del Departamento de Metrología de Llanogas SA ESP, que contiene fecha y número del certificado de calibración, la cual va adherida al equipo.

* La máxima diferencia en porcentaje, respecto a la full escala es de: 0,00%.

* El porcentaje de error así obtenido, es permitido en manómetros que corresponden a la clase de exactitud 1,00

* equipo presenta daño en su bourdon y no puede ser ajustado, se debe reemplazar instrumento.