


6. Resultados de la Calibración

AS FOUND. Resultados sistema de medición de temperatura.

No Prueba	Indicación Instrumento	Indicación Patrón	Error Max.	Resultado
				Error
1,000	20,287	20,000	0,287	0,287
2,000	29,897	30,000	-0,103	U
3,000	39,953	40,000	-0,047	0,397

DIAGRAMA DE CALIBRACION

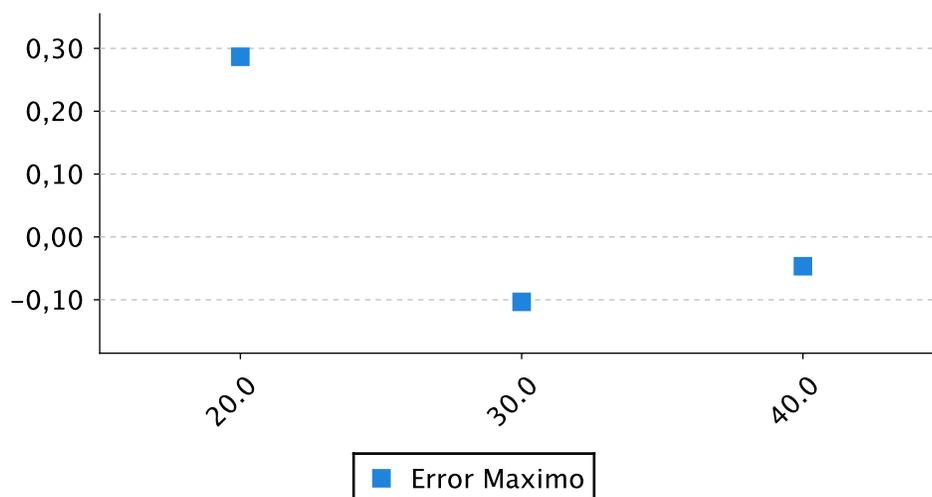


Max Error (%)=	0,287 %	±0,397
-----------------------	----------------	---------------

AS FOUND. Resultados sistema de medicion de presión.

Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	0,090	0,090	0,030%	0,067
75,000	75,130	0,130	0,043%	
150,000	150,200	0,200	0,067%	U
225,000	225,120	0,120	0,040%	0,026
300,000	300,150	0,150	0,050%	

DIAGRAMA DE CALIBRACION

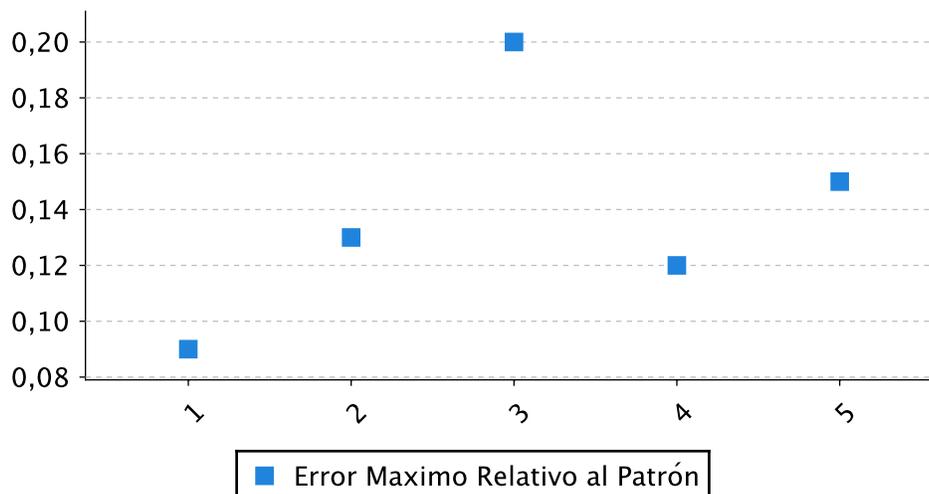

Max Error (%)=	0,067 %	±0,026
-----------------------	----------------	---------------

7. Observaciones

Remarks

* *El sistema de presión de 0.0 a 300.0 PSI no fue ajustado durante el proceso de calibración.*

* *El sistema de temperatura no fue ajustado durante el proceso de calibración.*

* *equipo en buen estado*