

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número: 000930

Página 1 de 5

LABORATORIO:

Laboratory

DEPARTAMENTO DE METROLOGIA

INSTRUMENTO:

Instrument

DETECTOR DE GAS

FABRICANTE:

Manufacturer

HANWEI

MODELO:

Model

GPT-100

NUMERO DE SERIE:

Serial Number

14092909004

UBICACIÓN

Location

LABORATORIO DE METROLOGIA

RANGO DE MEDICION:

Measurement Range

0 - 1 %Vol, 0 - 1000 ppm

RESOLUCIÓN:

Resolution

0.001, 1

SOLICITANTE:

Customer

LIDER DE METROLOGIA

DIRECCIÓN:

Address

CALLE 39 D N° 28 - 52

FECHA DE RECEPCIÓN:

Date of Reception

2020-01-17

FECHA DE CALIBRACIÓN:

Date of Calibration

2020-01-28

NUMERO DE PAGINAS INCLUYENDO ANEXOS:

Number of Pages and Document Attached

5

Calibrado Por:

Calibrate by:

Aprobado Por:

Checked by:

MIYER ALBERTO RETAVISCA

Técnico en Metrología

Ing. Fabian Contreras

Jefe Laboratorio de Metrología

Fecha De Emision null

Este reporte expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite. Los resultados contenidos en el presente Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

This report expresses faithfully the result of measurements. It may not be reproduced in whole or in part except when obtained prior written permission of the issuing laboratory. The results contained in this report refer to the time and conditions under which measurements were made. The laboratory that issues not responsible for damages that may result from improper use of calibrated instruments. The user is responsible for the recalibration of instruments at appropriate intervals.

1. No de Informe 930

Internal Code

2. Trazabilidad de la Medición

Traceability

Los patrones utilizados en la calibración de este instrumento están trazados a los patrones nacionales, los cuales tienen trazabilidad a patrones internacionales reconocidos.

Descripción (Description)	CILINDRO(SN FF18112)	CILINDRO(SN FF47223)
Tipo (Type)	CONCENTRACION	VOLUMEN
Fabricante (Manufacturer)	LINDE - CH4	LINDE - CH4
Serie	FF18112	FF47223
Rango de Medición	0 - 1000 ppm	0 - 1 %Vol
Resolución	1 ppm	0.2 %Vol
Certificado de Calibración	58765	56812

3. Metodo de Calibración.

Calibration Method

La calibración se realizó por comparación directa, entre el instrumento de medición y el patrón de referencia, utilizando el procedimiento descrito en el manual del fabricante.

4. Incertidumbre Estimada de la Medición.

Measurement uncertainty

La incertidumbre de medición (U), reportada en la tabla de resultados, es la incertidumbre estandar combinada, multiplicada por un factor de cobertura $k = 2$, con lo cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

5. Condiciones Ambientales

Enviromental Conditions


Temperatura Ambiente	55.4 °C
Room Temperature	
Humedad Relativa	23.5 HR
Relative Humidity	
Presión Atmosferica	1014.0 hpa
Atmospheric Pressure	

6. Resultados de la Calibración

De Llegada (AS FOUND)

N° de Prueba	Concentración del Patrón	Indicación Instrumento	Error	Error Promedio	U
1	1 %Vol	0,000	-1,000	-1,000	1,960
		0,000	-1,000		
		0,000	-1,000		
2	942 ppm	0,000	-942,000	-942,000	18,711
		0,000	-942,000		
		0,000	-942,000		


DIAGRAMA DE CALIBRACION

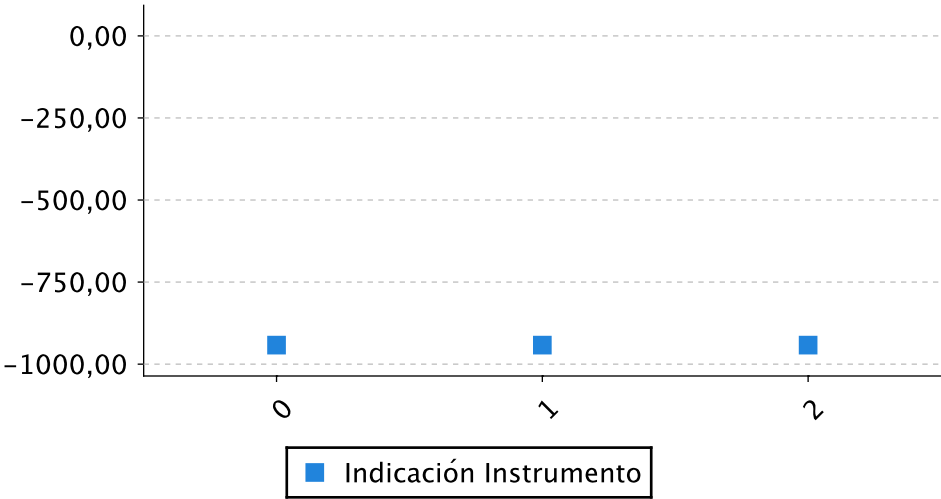

El porcentaje de error + incertidumbre (U) obtenido NO es permitido en detectores de gas portatil en base a las tolerancias descritas en el manual del equipo. Se requiere ajustar el equipo para disminuir el error del instrumento y efectuar una nueva calibración.

Calibración Después Del Ajuste (AS LEFT)

N° de Prueba	Concentración del Patrón	Indicación Instrumento	Error	Error Promedio	U
1	1 %Vol	0,000	-1,000	-1,000	1,960
		0,000	-1,000		
		0,000	-1,000		
2	942 ppm	0,000	-942,000	-942,000	18,711
		0,000	-942,000		
		0,000	-942,000		

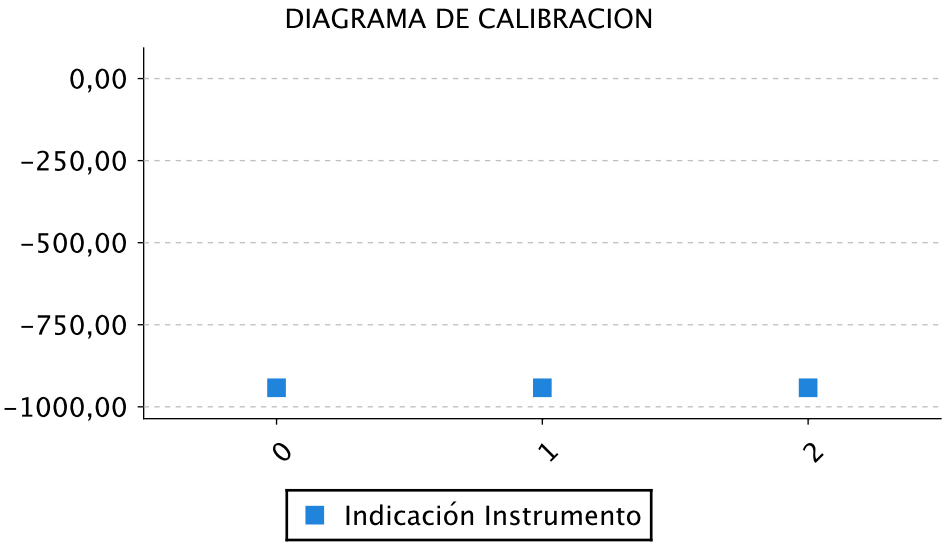

7. Observaciones

Remarks

* Con el certificado de calibración se entrega una estampilla del Departamento de Metrología de Llanogas SA ESP, que contiene fecha y número del certificado de calibración, la cual va adherida al equipo.

* El equipo llegó al laboratorio mostrando en el display falla de sensor, se le hizo prueba y se validó que el sensor sí estaba dañado, se le instaló sensor nuevo para realizarle pruebas nuevamente pero el equipo empezó a tomar lectura sin estar expuesto al gas, se le hizo limpieza y mantenimiento en general pero el equipo siguió comportándose igual, debido a que fue expuesto al polvo y la humedad se sulfató gran parte de la tarjeta y deterioró el cableado, por lo tanto no fue posible recuperar el equipo. se realizó informe 367 para dar de baja a equipo.