

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número: 011549

Página 1 de 5

LABORATORIO:

Laboratory

DEPARTAMENTO DE METROLOGIA

INSTRUMENTO:

Instrument

MANOMETRO DIGITAL

FABRICANTE:

Manufacturer

ADDITEL

MODELO:

Model

DIGITAL

NUMERO DE SERIE:

Serial Number

21814040021

UBICACIÓN

Location

LABORATORIO DE METROLOGIA

RANGO DE MEDICION:

Measurement Range

0 - 30 PSI

RESOLUCIÓN:

Resolution

0.001

SOLICITANTE:

Customer

LIDER DE METROLOGIA

DIRECCIÓN:

Address

CALLE 39D N° 28 - 52 EMPORIO

FECHA DE RECEPCIÓN:

Date of Reception

2023-03-24

FECHA DE CALIBRACIÓN:

Date of Calibration

2023-03-24

NUMERO DE PAGINAS INCLUYENDO ANEXOS:

Number of Pages and Document Attached

5

Calibrado Por:

Calibrate by:

Aprobado Por:

Checked by:

NICOLAS LOPEZ
Técnico en Metrología

Ing. Fabian Contreras
Jefe Laboratorio de Metrología

Fecha De Emision 2023-03-27

Este reporte expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite. Los resultados contenidos en el presente Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

This report expresses faithfully the result of measurements. It may not be reproduced in whole or in part except when obtained prior written permission of the issuing laboratory. The results contained in this report refer to the time and conditions under which measurements were made. The laboratory that issues not responsible for damages that may result from improper use of calibrated instruments. The user is responsible for the recalibration of instruments at appropriate intervals.

1. No de Informe 11549

Internal Code

2. Trazabilidad de la Medición

Traceability

Los patrones utilizados en la calibración de este instrumento están trazados a los patrones nacionales, los cuales tienen trazabilidad a patrones internacionales reconocidos.

Descripción (Description)	MANOMETRO DIGITAL(SN 218161B0035)
Tipo (Type)	PRESION
Fabricante (Manufacturer)	ADDITEL
Serie	218161B0035
Rango de Medición	0 - 30 PSI
Resolución	0.001 PSI
Certificado de Calibración	CMK-PRES-220526

3. Metodo de Calibración.

Calibration Method

Los lineamientos generales de calibración que se describen a continuación, se apoyan en las normas OIML R101, OIML R109 El manometro digital referido fue comparado con MANOMETRO DIGITAL, las lecturas del calibrando se efectuaron en ascenso y descenso; en el intermedio de las series el manometro digital se mantuvo durante veinte minutos en carga maxima.

4. Incertidumbre Estimada de la Medición.

Measurement uncertainty

La incertidumbre de medición (U), reportada en la tabla de resultados, es la incertidumbre estandar combinada, multiplicada por un factor de cobertura $k = 2$, con lo cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

5. Condiciones Ambientales

Enviromental Conditions

Temperatura Ambiente20.6 °C

Room Temperature

Humedad Relativa72.9 HR

Relative Humidity


Presión Atmosferica973.9 hpa

Atmospheric Pressure

6. Resultados de la Calibración

De Llegada (AS FOUND)

Indicación Patrón	Indicación Instrumento Ascenso	Indicación Instrumento Descenso	Error Max. Relativo A La Escala	Maxima de Presión
0.0	0.0	null	0,0000%	0,080
3.0	3.0	null	0,0000%	
6.0	6.0	null	0,0000%	
9.0	9.001	null	0,0033%	
12.0	12.002	null	0,0067%	
18.0	null	18.005	0,0167%	
21.0	null	21.005	0,0167%	
24.0	null	24.006	0,0200%	
27.0	null	27.006	0,0200%	
30.0	null	30.008	0,0267%	
15.0	15.004	15.003	0,0133%	U
0.0	null	0.0	0,0000%	1,897
3.0	null	3.0	0,0000%	
6.0	null	6.001	0,0033%	
9.0	null	9.001	0,0033%	
12.0	null	12.002	0,0067%	
18.0	18.005	null	0,0167%	

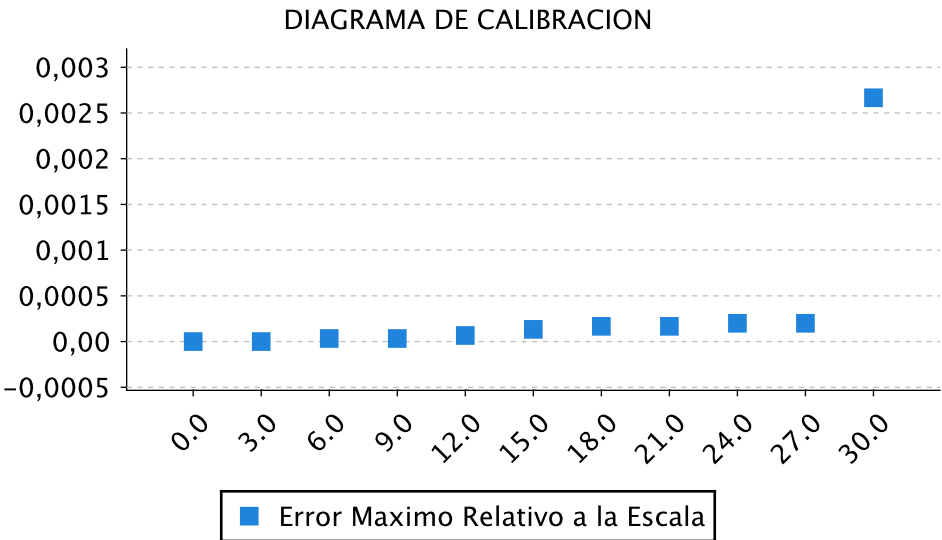


Max Error (%)=	0,267 %	±6,323
Max Error (PSI)=	0,080 PSI	±1,897

De Llegada (AS FOUND)

Indicación Patrón	Indicación Instrumento Ascenso	Indicación Instrumento Descenso	Error Max. Relativo A La Escala	Maxima de Presión
21.0	21.005	null	0,0167%	
24.0	24.006	null	0,0200%	
27.0	27.006	null	0,0200%	
30.0	30.08	null	0,2667%	

DIAGRAMA DE CALIBRACION

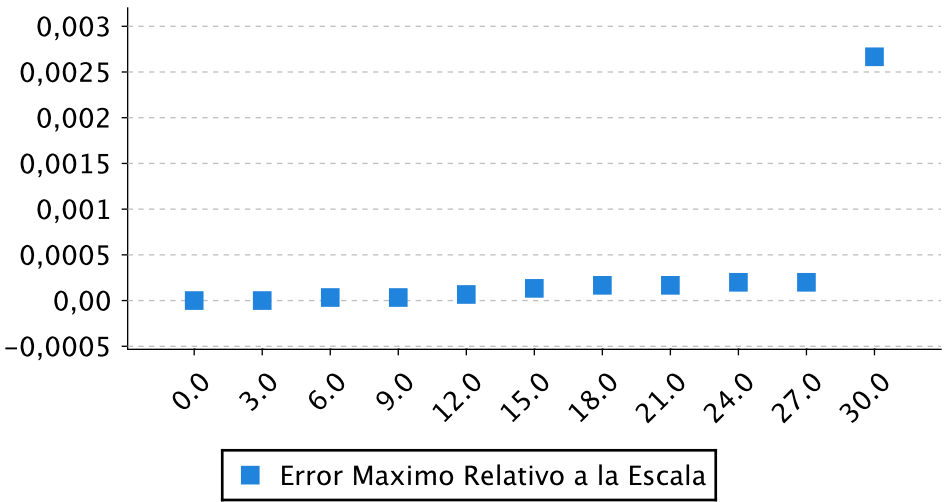

Max Error (%)=	0,267	%	±6,323
Max Error (PSI)=	0,080	PSI	±1,897

7. Observaciones

Remarks

* La máxima diferencia en porcentaje, respecto a la full escala es de: 0,27%.

* El porcentaje de error así obtenido, es permitido en manómetros que corresponden a la clase de exactitud 1,00

* Con el certificado de calibración se entrega una estampilla del Departamento de Metrología de Llanogás SA ESP, que contiene fecha y número del certificado de calibración, la cual va adherida al equipo.

* Se calibra equipo sin novedad.